

# 医薬品等の製造管理及び品質管理規則 (GMP)対応のための貸付機器

— 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器分野 —

和歌山県工業技術センター  
薬事産業部


# パーティクルカウンター

空間の微粒子を測定する装置。

製造現場やクリーンルームなどの空間の清浄度を調べるために用いる。

年1回校正済み。

型式:リオン製 KC-01E

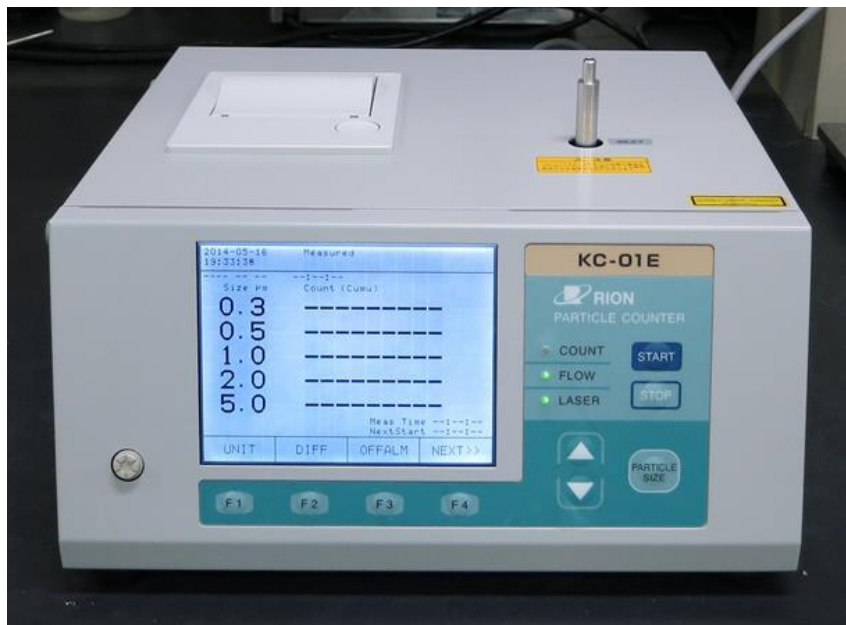

利用料金(1時間)  
: 200円

# プリンター付表面温度計

恒温槽や乾燥機、電気炉の点検に用いる。

温度計の表示が正確であるか、ホットプレートや乾燥機などの機器に示されている表示が正確であるかなどを確認することができる。

年1回校正済み。

型式：安立計器製 AP-400E

## ・プリンター付表面温度計本体及びセンサー①

センサーの長さ  
100mm  
使用温度限界  
400°C



利用料金(1時間)  
: 120円

## ・センサー②

センサーの長さ  
500mm  
使用温度限界  
500°C




# 波長透過率校正用光学フィルター

分光光度計を校正するために用いる。

日本薬局方 一般試験法 2. 24紫外可視吸光度測定法の1. 装置及び調整法に基づく機器の校正が実施できる。

年1回校正済み。

|               |              |         |
|---------------|--------------|---------|
| 波長校正用光学フィルター  | ホルミウム光学フィルター | JCRM002 |
| 透過率校正用光学フィルター | ND光学フィルター    | JCRM110 |
|               | ND光学フィルター    | JCRM150 |

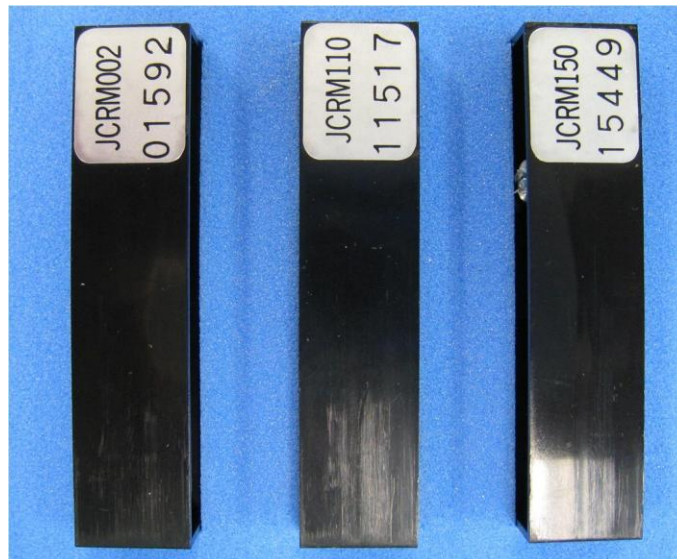

利用料金(1時間)

: 120円

# 標準分銅セット

天秤・はかりの校正に用いる分銅セット(1mg~200g、23個入)。  
年1回校正済み(1mg、100mg、1g、10g、50g、100g)。  
OIML E2準拠(1mg、100mg、1g、10g、50g、100g)。  
型式:ザルトリウス製 YCS01-522-00



利用料金(1時間)  
: 160円